


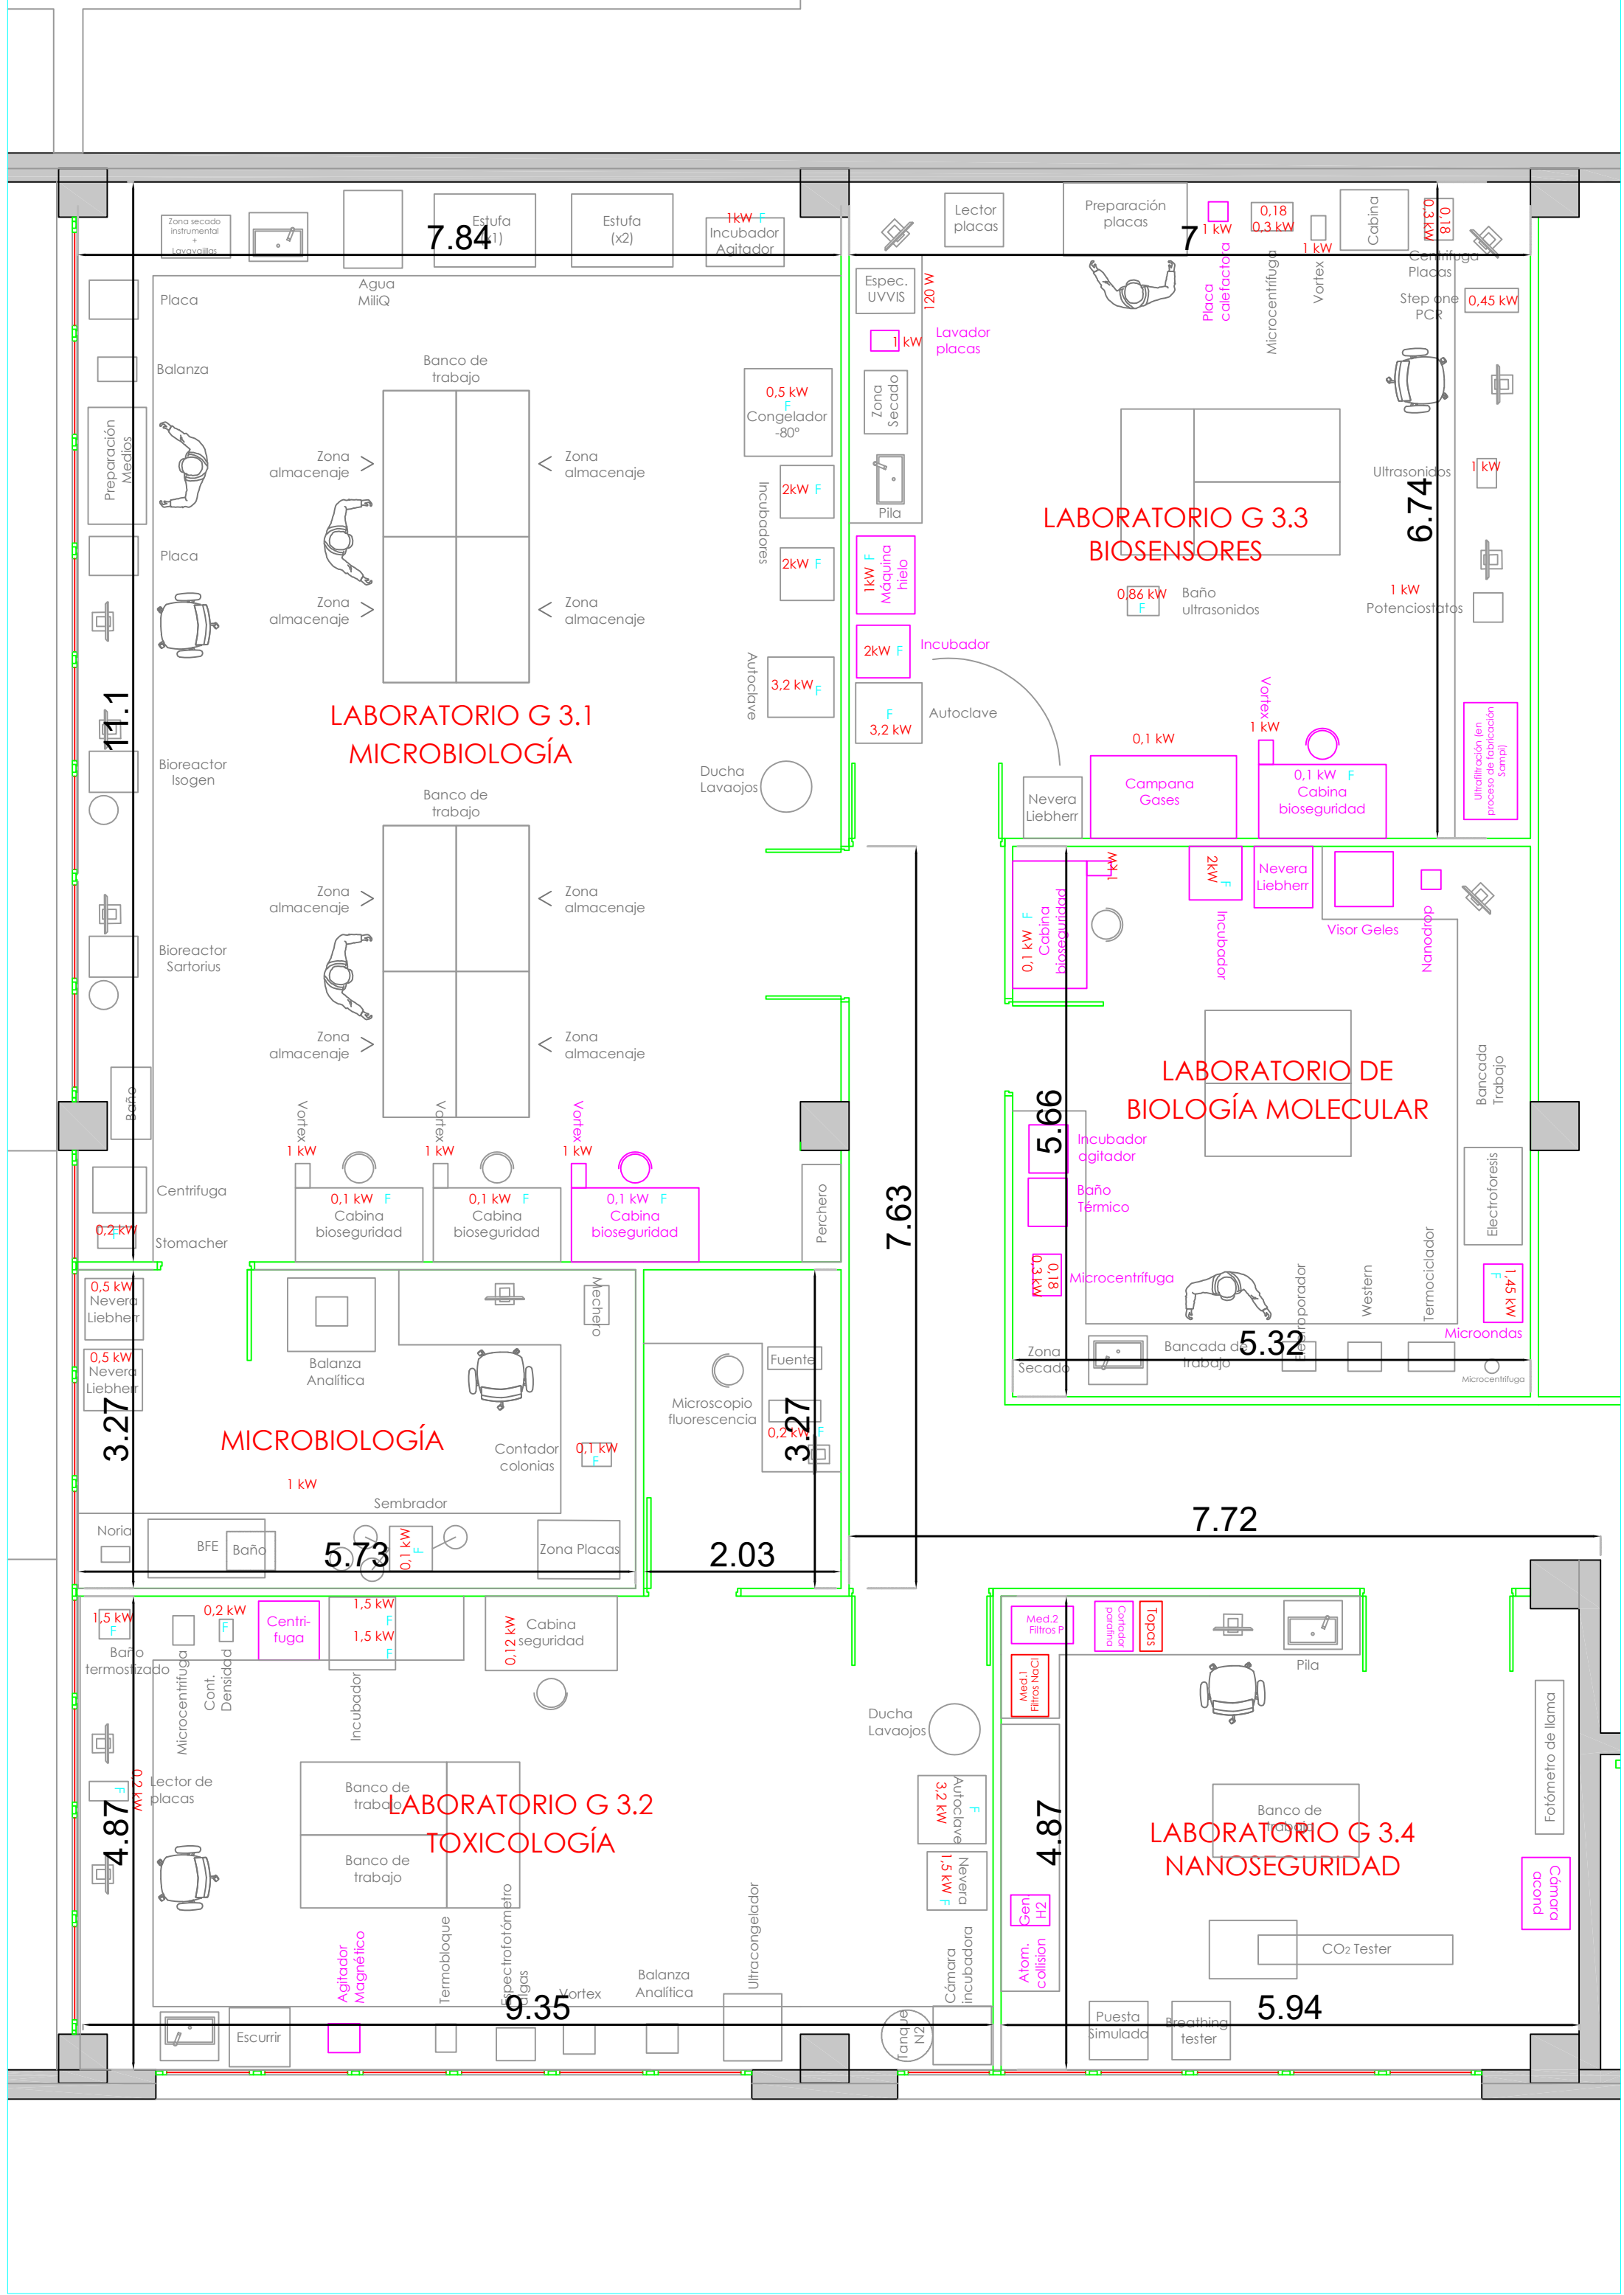

7.84

LABORATORIO G 3.1
MICROBIOLOGÍA

LABORATORIO G 3.3
BIOSENSORES

LABORATORIO DE
BIOLOGÍA MOLECULAR

MICROBIOLOGÍA

LABORATORIO G 3.2
TOXICOLOGÍA

LABORATORIO G 3.4
NANOSEGURIDAD

ITENE VINILO RIESGO N2 2025

		M2		SUBIDA APROX	M2 TOTALES
LABORATORIO G 3.2	9,35	4,87	45,53	14,22	46,9565
LABORATORIO G 3.4	5,94	4,87	28,93	10,81	30,0088
LAB. BIOLOGÍA MOLECULAR	5,66	5,32	30,11	10,98	31,2092
LABORATORIO G 3.3	7	6,74	47,18	13,74	48,554
LABORATORIO G 3.1	11,1	7,84	87,02	18,94	88,918
MICROBIOLOGÍA	5,73	3,27	18,74	9	19,6371
MICROSCOPIO FLUORESCENCIA	3,27	2,03	6,64	5,3	7,1681
PASILLO ACCESO	7,72	1,2	9,26	8,92	10,156
PASILLO GIRO	7,43	1,2	8,92	8,63	9,779
			282,33	100,54	292,3867